

新製品
・
人気製品

恒温槽 レンタルセレクション

新製品をレンタルにてご提供！

ハイパワー恒温(恒湿)器 ARシリーズ

急速温度変化タイプ「5℃/分」

ハイパワー恒温恒湿器は、試料からの発熱負荷に対応
温度変化、温湿度制御から最適機種をレンタルにてお選
び頂けます。



型式		ARS-0680-15	ARS-1100-10	ARG-0680-15	ARG-1100-10
温度 性 能	温度範囲	-70~+180℃			
	温度変化速度	-45℃⇔+155℃での平均			
		15℃/分	10℃/分	15℃/分	10℃/分
※1	許容発熱負荷	9500W (槽内温度：+20℃)			
能 ※ 1 性	温湿度範囲	+10~+95℃/10~98%rh		-	
	許容発熱負荷	600W (槽内温湿度：+85℃/85%rh)		-	

他の環境試験機も続々入荷中！ 掲載されていないモデルのご用意もございます。お問い合わせください。



小型超低温恒温器
MC-712
エスバック
温度範囲:-75~+100℃



恒温恒湿器
プラチナス J シリーズ
エスバック
温度範囲:-40~+100℃



サーモストリム
ATS-545-M
TEMPTRONIC
温度範囲:-75~+225℃



電気マッフル炉
FFW263PB
/FU000191
東洋製作所
温度範囲:100℃~1,150℃



ライトスペック恒温恒湿器
LHUシリーズ
エスバック
温度範囲:-20~+85℃
入力電源:AC100V1φ



恒温器
パーフェクトオープン
エスバック
温度範囲:+200℃/+200℃



小型環境試験器
SHシリーズ
エスバック
温度範囲:-40℃~+150℃




低温恒温恒湿器
NEOシリーズ
エタック
温度範囲:-40℃~+100℃

事例：恒温槽を用いた電子部品/電装品の評価

評価系すべての計測器をレンタルにてご提供いたします

EV/HEV 用インバータの評価には、高電圧バッテリー（車載電池）の代わりに高電圧直流電源と高電圧直流電子負荷を用いて評価をします。

また三相モータの絶縁不良のチェックとして、耐電圧絶縁試験も行います。電子負荷装置は、モータ評価時の回生電流による影響を抑制するためにも使用します。

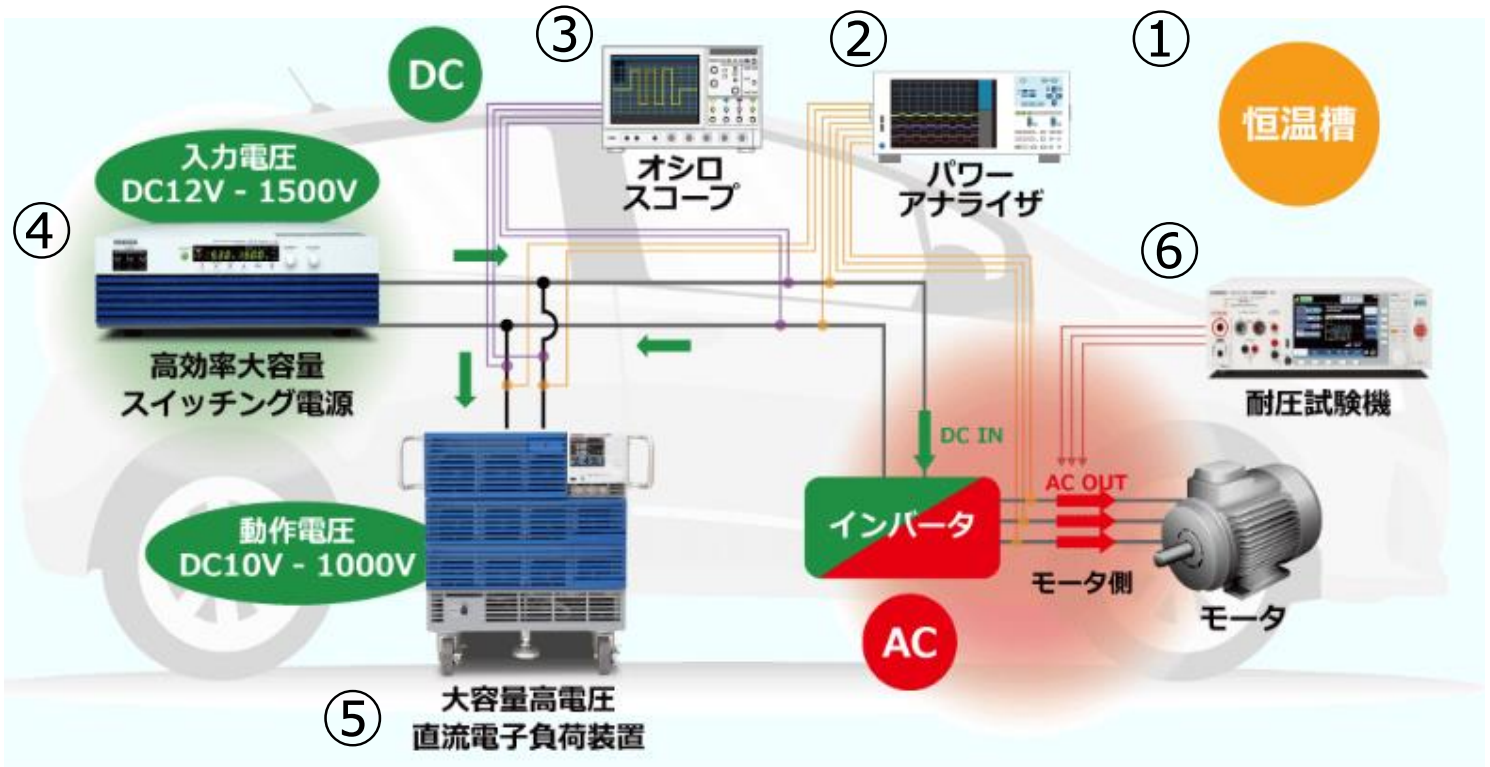

NO.	機器名	目的
①	恒温槽・PL-3J	環境試験
②	パワーアナライザ・PW6000	電力測定
③	オシロスコープ・MSO54	波形計測
④	DC電源・PAT8-400TM	入力電源・模擬電源
⑤	DC電子負荷・PLZ12005WH2	模擬負荷
⑥	耐圧試験機・TOS9303	AC/DC 耐圧試験・絶縁抵抗

高山理化精機株式会社

本社・営業部 〒399-0033 長野県松本市笹賀5652-18
 長野支店 〒381-2241 長野県長野市青木島町青木島乙265-1
 佐久営業所 〒385-0025 長野県佐久市塚原980-15
 南信営業所 〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村鳥居原8296-1
 北関東営業所 〒329-0205 栃木県小山市間々田1290-2
 新潟営業所 〒940-2111 新潟県長岡市三ツ郷屋町字下川原341-9
 山梨出張所 〒400-0123 山梨県甲斐市島上条747-1
 埼玉ブランチ 〒355-0025 埼玉県東松山市幸町9-24 サンシャインビル105

TEL: 0263-25-3111 FAX: 0263-26-8111
 TEL: 026-284-6111 FAX: 026-283-0130
 TEL: 0267-68-2111 FAX: 0267-68-4485
 TEL: 0265-76-6111 FAX: 0265-76-6981
 TEL: 0285-41-1772 FAX: 0285-41-1773
 TEL: 0258-28-7111 FAX: 0258-28-7113
 TEL: 055-269-9511 FAX: 055-269-9512
 TEL: 0493-81-3727 FAX: 0493-81-3860